
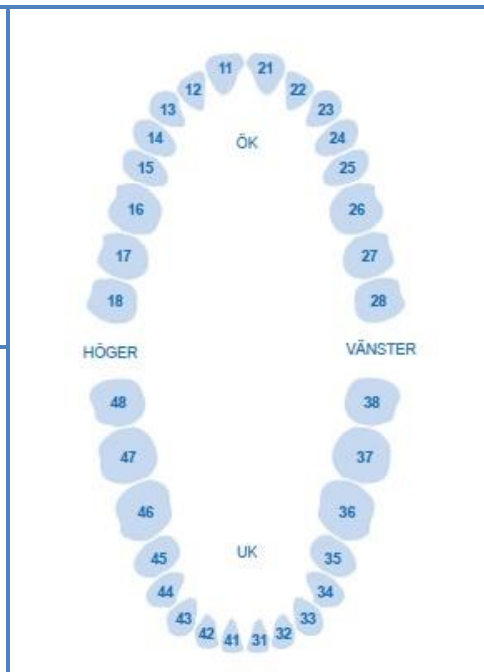


ARBETSANVISNING

Anvisning och förklaring för specialanpassad medicinteknisk produkt enligt förordningen (EU) MDR 2017/7

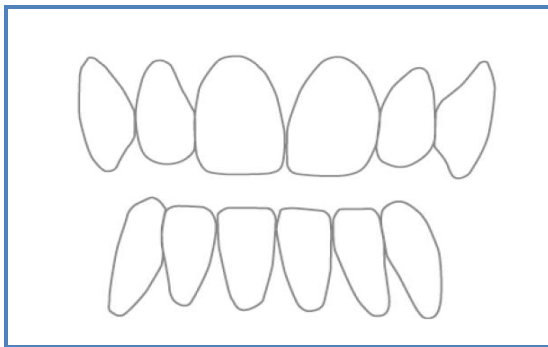

Glans:
Mattare Glansigare


Ytstruktur:
Lite Mycket

Infärgning:
Ingen Mycket

Leveranstider:
(antal arbetsdagar på laboratoriet)

Metall-keramik (1-4 led)	10
Monolitisk zirkonia krona	9
E.max	8
Helkeramisk bro (1-4 led)	9
Metallpelare	7
Temporär protes	8
Lagning/Basning protes	1-3
Ortodontiapparaturer	14
Stabiliseringskena	14
Resiliens-/blekskena	5

Önskas kortare leveranstid, kontakta oss!

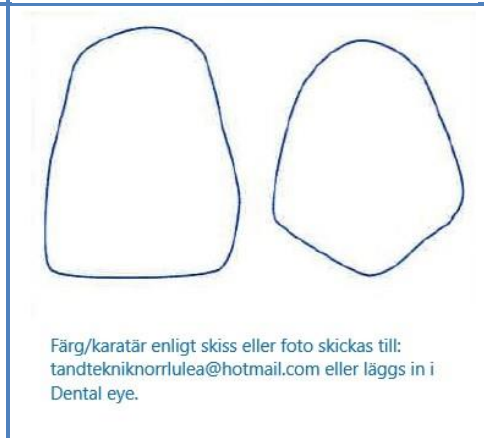

Tandteknik Norr, delmoment, namn

Desinficerat lab Desinficerat tdl

Slutkontroll lab sign.
Härmed intygas att produkten överensstämmer med de allmänna kraven på säkerhet och prestanda bilaga 1, MDR 2017/745

Information från Tandteknik Norr:

Tandläkare:	Datum beställning:
Klinik:	Index:
Adress:	Övrigt:
Postnr, Ort:	Ansvarig tandtekniker:
Tel behandlingsrum:	
Patient:	Personnr:

E.max <input type="checkbox"/>	Monolitisk zirkonia <input type="checkbox"/>	Zirkonia med ytporslin <input type="checkbox"/>
PMMA <input type="checkbox"/>	Co-cr <input type="checkbox"/>	Titan <input type="checkbox"/>

Färg: Foto finns på Dental eye/e-mail **Tandläkare sign:**

Anvisning:	Datum:
OBS! Glöm inte att göra en konstruktionsritning vid ex. avtagbar protetik eller ortodontiska apparaturer.	Provning:
	Provning:
	Önskar förlaga:
Arbetet är bokat med tandtekniskt laboratorium <input type="checkbox"/>	Fullt färdigt
Kontakta gärna oss om du har några frågor:	Datum
Luleå 0920-717 05	Tid